SANXIN

MP523-10 型
pH/铵离子浓度计

使用说明书

上海三信仪表厂

MP500 系列电化学仪表

一. 多参数测量仪

MP551 型 pH/mV/离子浓度/电导率/溶解氧测量仪

二. 双参数测量仪

1. MP521 型实验室 pH/电导率仪(pH：±0.01 pH；电导率：±1.0% FS)

2. MP522 型精密 pH/电导率仪(pH：±0.002 pH；电导率：±0.5% FS)

3. MP523 型 pH/离子浓度测量仪

3.1 MP523-01 型 pH/离子浓度计

3.2 MP523-02 型 pH/钠离子浓度计

3.3 MP523-03 型 pH/钙离子浓度计

3.4 MP523-04 型 pH/氟离子浓度计

3.5 MP523-05 型 pH/氯离子浓度计

3.6 MP523-06 型 pH/溴离子浓度计

3.7 MP523-07 型 pH/碘离子浓度计

3.8 MP523-08 型 pH/钾离子浓度计

3.9 MP523-09 型 pH/铜离子浓度计

3.10.1 MP523-10 型 pH/铵离子浓度计

3.10.2 MP523-10.2 型 pH/氨浓度计

3.11 MP523-11 型 pH/硝酸根浓度计

4. MP525 型 pH/溶解氧测量仪

5. MP526 型电导率/溶解氧测量仪

三. 单参数测量仪

1. MP511 型实验室 pH 计（±0.01 pH）

2. MP512 型精密 pH 计（±0.002 pH）

3. MP513 型实验室电导率仪（±1.0% FS）

4. MP515 型精密电导率仪（±0.5% FS）

5. MP516 型溶解氧仪

6. MP517 型钠离子浓度计

7. MP518 型钙离子浓度计

8. MP519 型氟离子浓度计

目 录

1. 概述 ---- 3
2. 技术参数 ---- 4
3. 仪器说明 ---- 5
3.1. LCD 显示 ---- 5
3.2. 操作键 ---- 6
3.3. 测量信息的储存、回显和清除 ---- 6
3.4. RS232 通讯 ---- 7
3.5. 插座 ---- 8
4. pH 测量 ---- 8
4.1. 准备工作 ---- 8
4.2. 电极校准 ---- 8
4.3. 溶液测量 ---- 9
4.4. 参数设置 ---- 9
4.5. 注意事项 ---- 12
4.6. 自诊断信息 ---- 14
5. mV 和 ORP 测量 ---- 14
5.1. 溶液测试 ---- 14
5.2. 注意事项 ---- 15
5.3. 参数设置 ---- 15
6. 铵离子浓度测量 ---- 16
6.1. 准备工作 ---- 16
6.2. 参数设置 ---- 16
6.3. 仪器校准 ---- 17
6.4. 溶液测试 ---- 18
6.5. 注意事项 ---- 18
7. 901 型智能搅拌器使用说明 ---- 19
技术规格、功能特点、使用方法、注意事项 ---- 19
8 仪器成套性 ---- 20
9 仪器保证事项 ---- 21
附表I 仪器参数设置一览表 ---- 22
附表II 仪器恢复出厂设置一览表 ---- 23
附表III 代码符号及缩写一览表 ---- 23
附件 1 仪器设置-校准溶液的其它浓度单位的设置过程 ---- 24
附件 2 菜单中没有列出的离子的设定 ---- 25
附件 3 铵离子选择电极使用的相关溶液和试剂 ---- 26

1. 概述：

感谢您购买和使用 MP523 型 pH/铵离子浓度测量仪（以下简称仪器)。

在您使用此仪器前，请仔细阅读使用说明书，以帮助您正确使用和维护。基于不断改良仪器性能之宗旨，本厂保留在不预先通知的情况下对本说明书内容及配件进行更改的权利。

本仪器是先进的电子技术、传感器技术和软件设计的完美结合，是性价比最优的实验室精密型 pH、mV 和离子浓度多参数测量仪，适用于石油、化工、医药、电厂和环保等行业，尤其在教育和科研领域具有更广泛的应用。

本仪器内置微处理器芯片、外型美观、功能丰富、使用方便，具有下列显著特点：符合国际规范的 GLP 要求，具有自动校准、自动温度补偿、数据储存、定时测量 、RS232 输出、时钟显示、功能设置和自诊断信息等智能化功能。

1.1. 采用数字滤波和滑差技术，智能改善仪表的响应速度和测量数据的准确性，测量值稳定时显示“ ☺ ”图标。

1.2. 自动识别 13 种 pH 标准缓冲溶液，有四个系列的标准缓冲溶液可以选择：中国系列、欧美系列、NIST 系列和自定义溶液。

1.3. 可设置高纯水 pH 测量模式和加氨纯水 pH 测量模式，对这二种特殊的 pH 测量模式，除了一般的斜率温度补偿外，还增加了溶液温度补偿功能，大大提高了测量准确度，特别适合电力、石化等行业使用。

1.4. 有 E_H 氧化还原电位测量模式，直接显示相对于标准氢电极电位的 ORP 值。

1.5. 本仪器配合铵离子选择电极（液膜电极)，能方便的测量样品中的铵离子浓度。

1.6. 自行设定二种校准溶液，自动校准，直接测出样品的离子浓度。

1.7. 仪器电路板采用 SMT 贴片工艺，提高了产品加工的可靠性。

1.8. 仪器带有唯一的产品序列号。

1.9. 仪器符合 IP54 防尘防溅等级，所有插口都有硅胶帽密封保护。

2. 技术参数:

2.1. pH:

测量范围	(-1.999 ~ 19.999) pH
分辨率	0.1/0.01/0.001 pH
准确度	电计: ±0.002 pH，配套: ±0.01 pH
输入电流	$\leq 1\times10^{-12}$ A
输入阻抗	$\geq 3\times10^{12}\ \Omega$
稳定性	±0.002 pH/3h
温度补偿范围	(0 ~ 100) ℃ (自动或手动)

2.2. mV:

测量范围(mV/ORP/E_H)	-1999.9mV ~ 0 ~ 1999.9mV
分辨率	0.1mV
准确度	±0.03% FS

2.3. 铵根离子浓度:

测量范围	(1.00 ~ 5.00) pNH_4 或 (1800 ~ 0.18) mg/L
溶液 pH 范围	(2-9) pH
显示单位	无单位 (pNH4)、mol/L、mg/L、ppm
准确度	电计: ±0.5 %读数值(一价)，1.0 %读数值(二价)
温度补偿范围	(0 ~ 60) ℃ (自动或手动)

2.4. 温度:

测量范围	-10℃~ 110℃
分辨率	0.1℃
准确度	(5~ 60) ℃范围: ±0.4℃ 其余范围: ±0.8℃

2.5. 其他技术参数:


数据储存	900 组
储存内容	测量值编号、测量值、温度值、ATC 或 MTC 状态、测量日期、测量时间
电源	DC9V/300mA
通讯接口	RS232
尺寸和重量	160 × 190 × 70mm/880g
质量和安全认证	ISO9001:2000, CE 和 CMC

2.6. 工作条件:

环境温度	(5 ~ 40) ℃ (0.01 级) (15 ~ 30) ℃ (0.001 级)
环境湿度	≤75%
IP 等级	IP54 防尘防溅

3. 仪器说明：

3.1. LCD 显示：

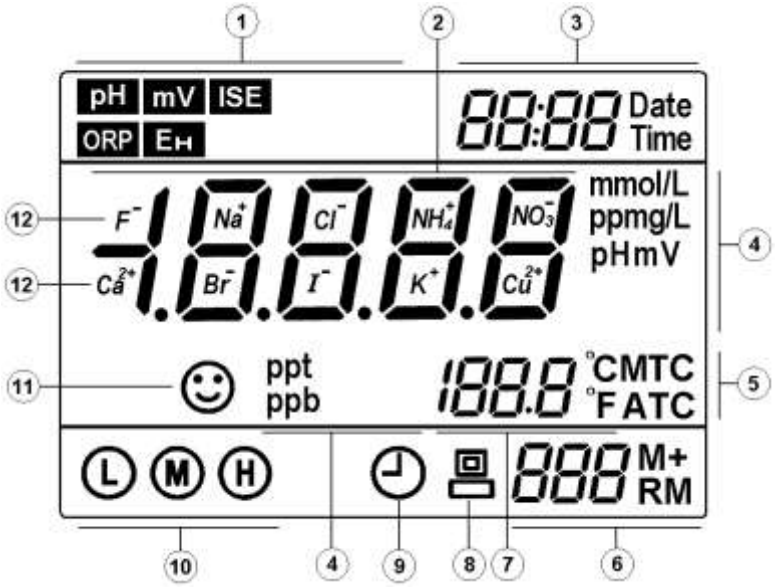

① —— 参数模式图标

② —— 测量值

③ —— 时间与日期，以及特殊测量状态的提示符号

④ —— 测量单位

⑤ —— 温度补偿状态图标：ATC — 自动温度补偿

MTC — 手动温度补偿

⑥ ——测量值储存及回显的编号和图标。M+ — 测量值储存图标；RM — 测量值回显图标；左边数字表示编号。

⑦ —— 温度测量值及单位

⑧ —— RS232 通讯图标，此图标显示时，表示仪器与电脑已连接。


⑨ —— 定时测量图标

⑩ —— 电极校准指示图标

⑪ —— 测量值稳定图标

⑫ —— 离子符号

3.2. 操作键:

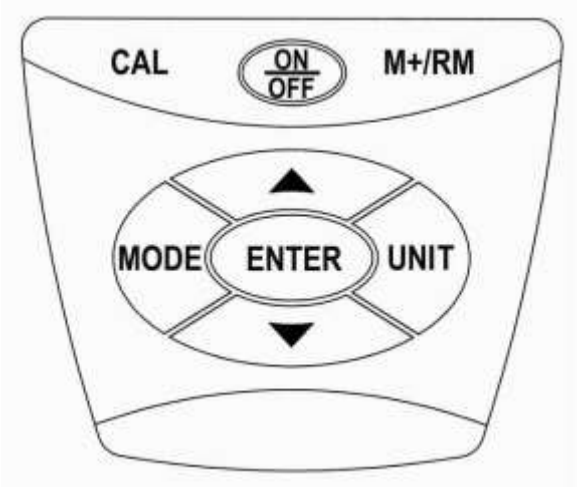

短按一按键时间<1.5 s　　长按一按键时间>2 s

表 1 按键操作和功能一览表

按键	操作	功能
ON/OFF	短按	● 开关电源
CAL	短按	● 在测量模式时，按键进入仪器校准模式
MODE	短按	切换测量参数，依次显示 pH → mV → ISE (离子浓度)。 ● 进入 P1 之后短按，依次显示 P2 ， P3 ……
	长按	● 进入参数设置模式 P1
UNIT	短按	● 在 pH 模式时，按键改变 pH 值的分辨率：0.001→0.01→0.1Ph ● 在 mV 模式时，按键依次改变参数模式：mV → ORP → EH ● 在 ISE 模式时，按键依次改变单位符号：pX→mol/L→mg/L→ppm ● 在参数设置状态时，按键选择参数修改位置 **说明：切换单位后，下次开机时将显示该单位符号**
ENTER	短按	● 在校准状态或参数设置状态时按键表示确认，按键后仪器进入测量状态
▲	短按	● 在 MTC 状态时，按键增加或减少温度值，短按一次改变 0.1℃ ● 在参数设置状态时，按键改变数字或 ON/OFF 状态
▼	长按	● 在 MTC 状态时，按键增加或减少温度值，长按时温度快速改变
M+/RM	短按	● 储存测量数据
	长按	● 回显储存的测量数据

3.3. 测量信息的储存、回显和清除：

3.3.1. 储存测量信息：

(a) 在测量模式下，当测量值已稳定，显示“ ☺ ”图标时，短按 <M+/RM> 键，LCD 将显 示**“M+”**图标和储存编号，同时将测量值信息（包括时间、日期、编号、测量值、测量单位、温度值、温度补偿状态等内容）全部储存。仪器在 pH、mV 和离子浓度测量模式中可分别储存 300 组测量信息，总计可以储存 900 组。

(b) 当设置定时测量功能时，LCD 将显示“ ◴ ”图标，同时仪器将按照所设定的时间，定时测量并储存测量信息。

3.3.2. 回显测量信息：

(a) 在测量模式下，长按 <M+/RM> 键，仪器将回显最后一组储存的信息，LCD 右下角显示储存编号和**“RM”**图标，以及完整的测量信息，测量时间和日期在 LCD 右上角会交替显示。再按 <▼> 或 <▲> 键，仪器将依次回显所有的测量信息，长按<▼> 或 <▲> 键，可快速查询其他编号的测量信息；

(b) 在回显模式下(LCD 右下角有**“RM”**图标和储存编号)，按 <ENTER> 键将返回测量模式。

3.3.3. 清除储存的测量信息：

在回显模式下，长按 <M+/RM> 键 5s，LCD 显示“ CLr ”符号 2s，表示内存已清除，然后返回测量模式。


3.4. RS232 通讯：

3.4.1. 本仪器使用 MP523 通讯软件，可实现 RS232 通讯功能，本应用软件对计算机的要求是：能稳定运行 Windows XP 操作系统的个人电脑（已安装好 Microsoft Excel 2000 或更高级别的版本），根据分辨率选择不同的设置（1280×1024 或 1280×800），按提示安装好 MP523 通讯软件。打开 MP523 通讯软件并连接仪器，LCD 将显示 RS232 通讯图标“ 🖳 ”，同时仪器储存的所有测量信息均上传给计算机，包括测量值、测量单位、温度值、温度补偿状态（ATC 或 MTC），以及最后一次的校准信息（校准时间、日期和溶液）。

3.4.2. 当仪器与计算机连接后，再按 <M+/RM> 键，或设置定时测量功能，测量信息均通过 RS232 上传给计算机，不会储存在仪器中，计算界面还会显示测量值与时间的变化曲线图。

3.4.3. 所有对测量信息的分析、统计、打印等功能，通过计算机界面上的“导出”按键，均可在“ Microsoft Excel ”文档中进行操作。

3.5. 插座：

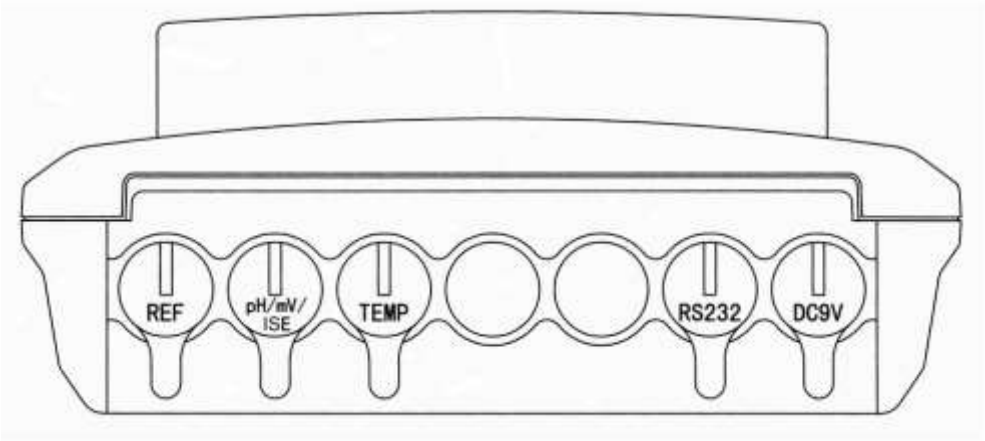

3.5.1. REF — 参比电极插座

3.5.2. pH/mV/ISE — pH 电极、离子选择电极和 ORP 电极的插座（BNC 插座）

3.5.3. TEMP — 温度电极插座（RCA 话筒插座）

3.5.4. RS232 — RS232 通讯接口插座

3.5.5. DC9V — DC9V 电源插座，Φ2.5 ，内“+”外“-”。

4. pH 测量：

4.1. 准备工作：

4.1.1. 接入电源，按< ON/OFF >键开机。

4.1.2. 短按 < MODE > 键切换至 pH 模式。

4.1.3. 安装电极架并调试。

4.1.4. 将 pH 电极接入仪器插座中。

4.2. 电极校准：

4.2.1. 按 < CAL > 键仪器进入校准模式，LCD 显示闪烁的“ CAL 1 ”，提示进入第一点校准。

4.2.2. 将 pH 电极在纯水中洗净并吸干，浸入 pH6.86 缓冲溶液中，晃动电极架后静止放置，等测量值稳定并显示“ ☺ ”图标时，再按 < CAL > 键，LCD 显示闪烁的 6.864 pH，几秒钟后校准完成，显示稳定的 pH 值和闪烁的“ CAL2 ”，提示已完成第一点校准，

进入第二点校准。

4.2.3. 将 pH 电极在纯水中洗净并吸干，浸入 pH4.00 缓冲溶液中，晃动电极架后静止放置，等测量值稳定并显示“ ☺ ”图标时，再按 <CAL> 键，LCD 显示闪烁的 4.003 pH，几秒钟后校准完成，显示稳定的 pH 值和闪烁的“ CAL 3 ”，提示已完成第二点校准，进入第三点校准。

4.2.4. 将 pH 电极在纯水中洗净并吸干，插入 pH9.18 缓冲溶液中，晃动电极架后静止放置，等测量值稳定并显示“ ☺ ”图标时，再按 <CAL> 键，LCD 显示闪烁的 9.182 pH，几秒钟后校准完成，显示稳定的 pH 值和“ Ⓛ Ⓜ Ⓗ ”三个校准指示图标，见图（4-1），提示三点校准已完成，进入测量模式。



图（4-1）

4.2.5. 说明：

(a) 本仪器可以任意采用一点、二点或三点自动校准，当第一点校准完成后（见 4.2.2.条），按 <ENTER> 键确认一点校准并进入测量模式，LCD 左下角显示一点校准的指示图标“ Ⓜ ”。当测量精度≤±0.1pH 时，根据测量范围选择一种缓冲溶液进行一点校准就可以了。

(b) 当第二点校准完成后（见 4.2.3.条），按 <ENTER> 键确认二点校准并进入测量模式，LCD 左下角显示二点校准的指示图标“ Ⓛ Ⓗ ”。如果测量值仅在酸性范围，可选择 pH4.00 和 pH6.86 校准；如果测量仅仅在碱性范围，可选择 pH6.86 和 pH9.18 校准。

(c) 如果测量范围比较宽，或 pH 电极使用时间较长有老化现象时，应选择三点校准，这会使测量准确度更高。但首次使用的 pH 电极，必须进行三点校准，使仪器的斜率调整至与 pH 电极一致。

4.3. 溶液测量：

将 pH 电极洗净后吸干，浸入被测溶液中，晃动电极架后静止放置，待 LCD 显示“ ☺ ”图标，显示值稳定后读数，即为该溶液的 pH 值。

注意：（a）被测溶液的温度与校准溶液的温度越接近，其测量准确度越高，这是 pH 的等温测量原理；


（b）仪器配置二支 pH 电极，一般使用时，建议使用 201T-M 塑壳 pH/ATC 三复合电极。对高精度测量，或离子强度较低、浑浊液体和胶体溶液的测量，建议使用 Labsen211 玻璃 pH 复合电极。

4.4. 参数设置：

4.4.1. pH 测量参数设置一览表（见附表 1）

4.4.2. pH 缓冲溶液系列选择（P1）

(a) 长按 <MODE> 键，仪器进入 P1 模式，见图（4-2）；

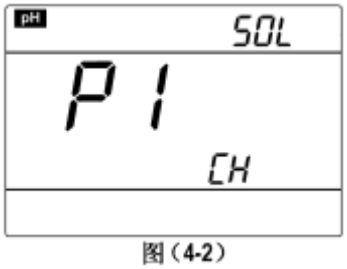

图（4-2）

(b) 按<▲>或<▼>键选择缓冲溶液系列：

CH (中国系列) — 1.680、4.003、6.864、9.182、 12.460 pH

USA(欧美系列) — 1.679、4.005、7.000、10.012、12.454 pH


n 15(NIST 系列) — 1.679、4.006、6.865、9.180、12.454 pH

(c) 按 <MODE> 键进入下一项参数设置或按 <ENTER> 键确认并返回测量模式；

(d) 出厂设置为 USA（欧美系列）。

4.4.3. pH 缓冲溶液“自定义”的设置：

对某些特殊的校准溶液，用户可以在“自定义”模式中进行设置，但必须特别注意，“自定义”设置的参数是某一固定温度下的数值，仪器必须在相同的温度下进行校准和测量，否则会有较大的误差。以下是“自定义”设置的步骤。

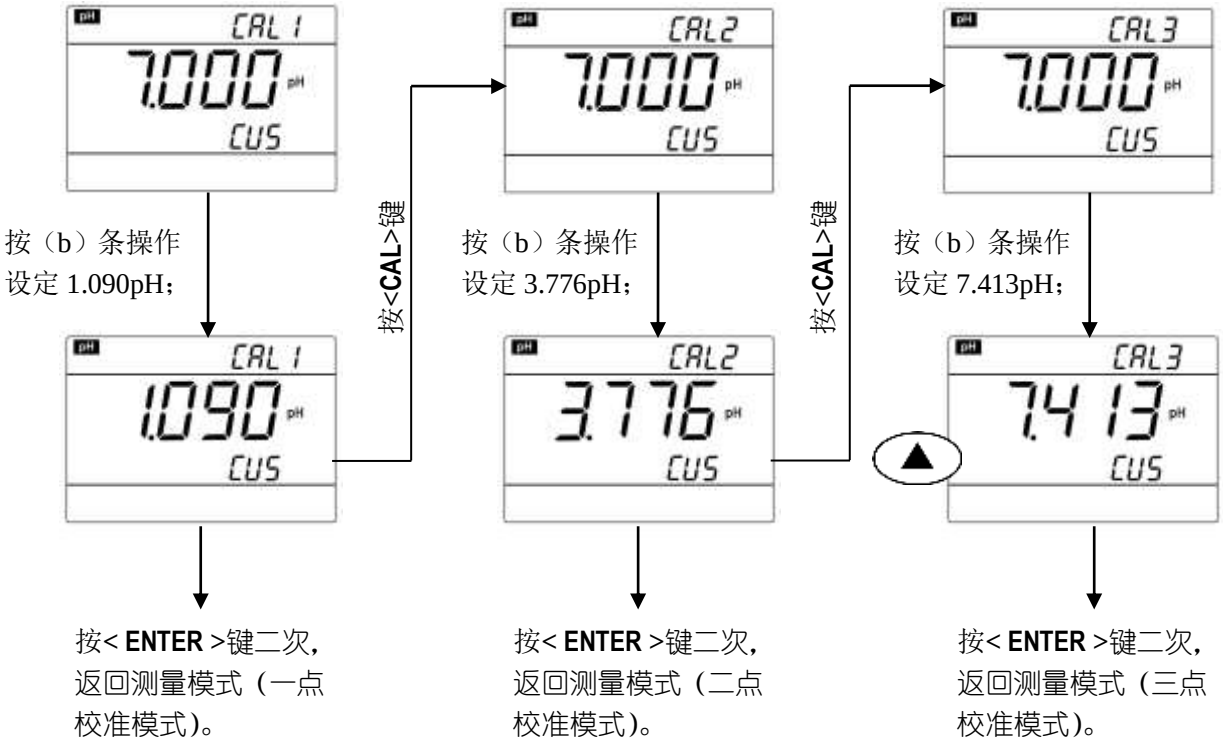

图（4-3）

(a) 长按 <MODE> 键进入 P1，按<▲>或<▼>键选择校准溶液系列为“CUS”，再按 <CAL> 键进入设置界面，如图（4-3）所示，右上角“CAL 1”表示第一个校准点的设置；

(b) 按 <UNIT> 键数字依次右移并闪烁，在数字闪烁时按<▲>或<▼>键修改大小，按此操作设定数值。图（4-3）是一点校准设置、二点校准设置和三点校准设置的全过程。

注意：如果选择了“CUS”设置，在测量模式时 LCD 右上角（时间显示部分）会显示“CUS”图标。

4.4.4. 纯水 pH 温度补偿设置（P2）

(a) 在 P1 模式下短按 <MODE> 键，仪器进入 P2 模式，见图（4-4）；



图（4-4）

(b) 按<▲>或<▼>键选择“On”(纯水 pH 温度补偿设置）或“OFF”（关闭）；

(c) 按 <MODE> 键进入下一项参数设置或按 <ENTER> 键确认并返回测量模式；

(d) 出厂设置为**“OFF”**。

注意：如果设置了纯水温度补偿功能，在测量模式时 LCD 右上角会显示“PU-1”图标。

4.4.5. 加氨纯水 pH 温度补偿设置（P3）

(a) 在 P2 模式下短按 <MODE> 键，进入 P3 模式，见图（4-5）；



图（4-5）

(b) 按<▲>或<▼>键选择“On”（加氨纯水 pH 温度补偿设置）或“OFF”（关闭）；


(c) 按 <MODE> 键进入下一项参数设置或按 <ENTER> 键确认并返回测量模式；

(d) 出厂设置为**“OFF”**。

注意：如果设置了加氨纯水 pH 温度补偿功能，在测量模式时 LCD 右上角会显示“PU-2”图标。

4.4.6. 定时测量时间设置（P4）

(a) 在 P3 模式下短按 <MODE> 键，进入 P4 模式，见图（4-6）；

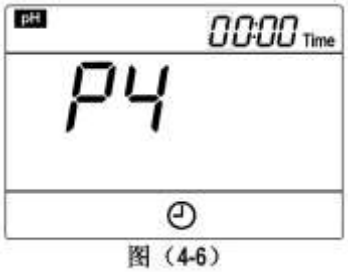

图（4-6）

(b) 按 <UNIT> 键，“0”依次右移并闪烁，在数字闪烁时按<▲>或<▼>键修改大小；

(c) 按 <MODE> 键进入下一项参数设置或按 <ENTER> 键确认并返回测量模式；

(d) 出厂设置为**“0”**秒。


注意：格式“ 00:00 ”中“：”前的数字表示分钟，最大可设置为 99；“：”后的数字表示秒，最大为 59。设置了定时测量模式后，LCD 显示“ ”图标。

4.4.7. 温度单位℃/℉设置（P5）

(a) 在 P4 模式下短按 <MODE> 键，进入 P5 模式，见图（4-7）；

(b) 按<▲>或<▼>键可选择温度单位℃或℉；

(c) 按 <MODE> 键进入下一项参数设置或按 <ENTER> 键确认并返回测量模式。

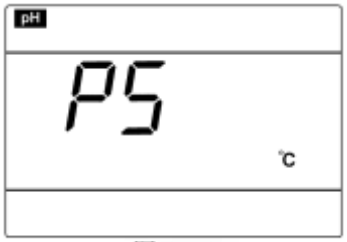

图（4-7）

4.4.8. 日期设置（P6）

(a) 在 P5 模式下短按 <MODE> 键，进入 P6 模式，见图（4-8）；

(b) 按 <UNIT> 键，数字右移并闪烁，在数字闪烁时按<▲>或<▼>键修改大小。日期设置右上角是月—日，右下角是年；

(c) 按 <MODE> 键进入下一项参数设置或按 <ENTER> 键确认并返回测量模式。




图（4-8）

4.4.9. 时间设置（P7）

(a) 在 P6 状态下短按 <MODE> 键，进入 P7 模式，见图（4-9）；

(b) 按 <UNIT> 键，数字右移并闪烁，在数字闪烁时按<▲>或<▼>键修改大小；

(c) 按 <MODE> 键进入下一项参数设置或按 <ENTER> 键确认并返回测量模式。

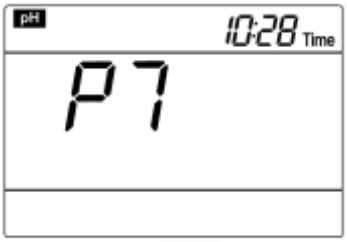

图（4-9）

4.4.10. 恢复出厂设置（P8）

(a) 在 P7 模式下短按 <MODE> 键，进入 P8 模式，见图（4-10）；

(b) 按<▲>键选择“On”，表示 pH 测量中的参数已恢复到出厂设置模式，2s 后返回测量模式。



图（4-10）

特别注意：当参数设置内容与出厂设置内容一致时，pH 测量界面如图（4-1）所示，LCD 右上角显示时间，当部分参数设置内容与出厂设置内容不同时，LCD 右上角将显示代码图标，当设置过二个以上有显示代码的参数

时，LCD 只显示其中一个代码图标，使用者应进入参数设置界面仔细查看设置的内容，或者将仪器恢复到出厂设置模式，再重新设置需要的参数。

4.5. 注意事项：

4.5.1. 仪器校准的次数取决于试样、电极性能及对测量的准确度要求。高精度测量（≤±0.02pH），应及时校准并使用准确度高的标准缓冲溶液，一般精度测量（≥±0.1pH），经一次校准后可连续使用一周或更长时间。

4.5.2. 在下列情况时，仪器要重新校准：

(a) 长期未用的电极和新换的电极；

(b) 测量强酸溶液(pH<2)或强碱溶液(pH>12)以后；

(c) 测量含有氟化物的溶液或较浓的有机溶液以后；

(d) 被测溶液温度与校准时的温度相差过大时。

4.5.3. 如果不使用温度电极，按<▲>或<▼>键可以调整温度值，进行手动温度补偿。

4.5.4. pH 电极前端的保护瓶内有电极浸泡溶液，电极头浸泡其中，以保持玻璃球泡和液接界的活化。测量时旋松瓶盖，拔出电极，用纯水洗净即可使用。使用后再将电极插进并旋紧瓶盖，以防止溶液渗出，如发现保护瓶中的浸泡液有混浊，发霉现象，应及时洗净，并调换新的浸泡液。

4.5.5. 电极浸泡液的配制：称取 25g 分析纯 KCl 溶于 100mL 纯水中即成。电极应避免长期浸泡在纯水、蛋白质溶液和酸性氟化物溶液中，并防止和有机硅油脂接触。

4.5.6. 仪器用已知 pH 值的标准缓冲溶液进行校准时，为了提高测量精度，缓冲溶液的 pH 值要可靠。多次使用后缓冲溶液要及时更换。

4.5.7. 经常保持仪器的清洁和干燥，特别要注意保持电计、电极插口的高度清洁和干燥，否则将导致测量失准或失效，如有沾污可用医用棉花和无水酒精揩净并吹干。

4.5.8. 复合电极前端的敏感玻璃球泡，不能与硬物接触，任何破损和擦毛都会使电极失效。测量前和测量后都要用纯水清洗电极，清洗后将电极甩干或吸干，不要用纸巾揩试球泡，这样会使电极电位不稳定，延长响应时间。在粘稠性试样中测定后，电极需用纯水反复冲洗多次，以除去粘在玻璃膜上的试样，或先用适宜的溶剂清洗，再用纯水洗去溶剂。

4.5.9. 电极经长期使用，或被测溶液中含有易污染敏感玻璃球泡或堵塞液接界的物质，而使电极钝化，其现象是敏感梯度降低，响应缓慢，读数不准，可根据不同情况采取下列措施：

(a) 玻璃球泡污染老化：将电极用 0.1mol/L 稀盐酸（配制：9mL 盐酸用纯水稀释至 1000mL）浸泡 24h，用纯水洗净，然后再用电极浸泡液浸泡 24h，如果钝化比较严重，也可将电极球泡在 4%HF（氢氟酸）溶液中浸泡（3~5）s，用纯水洗净，然后在电极浸泡液中浸泡 24h，使之复新（操作应该在通风橱中进行)。

(b) 玻璃球泡和液接界污染的清洗：（供参考）

污染物	清洗剂
无机金属氧化物	低于 1mol/L 稀酸
有机油脂类物	稀洗涤剂（弱碱性）
树脂高分子物质	稀酒精、丙酮、乙醚
蛋白质血球沉淀物	5%胃蛋白酶+0.1mol/L HCl 溶液
颜料类物质	稀漂白液、过氧化物

4.5.10. pH 电极使用周期为一年左右，但如果使用条件恶劣或保养不当，使用时间会缩短，电极老化或失效后应及时更换新的电极。

4.5.11. 当仪器校准或显示出现不正常时，请设置 P8 为**“On”**，使仪器恢复出厂设置状态，再进行校准和测试。

4.5.12. 请不要在开机时拔出电源，只有在仪器关机后才能拔出电源适配器的插头。

4.6. 自诊断信息：

仪器在使用过程中，可能会出现以下的一些符号，这是仪器的自诊断信息，它可以帮助你了解仪器或电极使用中的一些问题：

4.6.1. 静止不动的**“** -2.000 **”**pH 或**“** 19.999 **”**pH — 这是测量值超过测量范围时显示的符号，当电极与仪器未连接好，电极悬空未进入溶液，均可能出现此符号，这是一种正常的现象。

4.6.2. **“** Err 1 **”** — 电极零电位超标（<-60mV 或>60mV）

4.6.3. **“** Err2 **”** — 电极斜率超标（<85%或>105%）

当出现以上**“** Err 1 **”**或**“** Err2 **”**符号时，仪器将不能工作，请进行以下检查：

(a) 检查电极球泡中是否有气泡，如有请用力甩去气泡；

(b) 检查缓冲溶液是否已变质，或有较大的误差；

(c) 将仪器恢复出厂设置模式（详见 P13 第 4.4.10.条），再重新校准。

如经过以上检查还不能恢复正常，请更换新的 pH 电极。

5. mV 和 ORP 测量:

5.1. 溶液测试:

5.1.1. 按<ON/OFF>键开机，按 <MODE> 键切换至 mV 档，按 <UNIT> 键选择 mV → ORP → E_H 。

(a) mV — 这是电极电位的测量模式。mV 值和温度值同时显示;

(b) ORP — 这是 ORP 电极的测量模式。ORP 测量没有温度补偿，所以此模式没有温度显示;

(c) E_H — 这是一种特殊的 ORP 测量模式。直接显示相对于标准氢电极的 ORP 电位，E_H 值和参比电极电位有关，仪器出厂设置的参比电极电位是 204.6mV（3.5mol/L KCl、Ag/AgCl 参比电极的标准电位)，是与本厂提供的 ORP 电极配套的，如选用其它的 ORP 电极，请根据其技术参数查出它的标准电位值，并在仪器参数设置 P1 中进行设置（参见 P16 第 5.3.2.条)。

注 — ORP 是英文“Oxidation-Reduction Potential”的缩写，表示溶液的氧化还原电位，ORP 是水溶液氧化还原能力的测量指标，单位是 mV。

5.1.2. 接上 ORP 电极或离子电极，浸入被测溶液中，稍加搅动后静止放置，待“ ☺ ”出现，显示值稳定后读数，即为 ORP 值或离子电极的电位值。

5.1.3. 如果 ORP 电极或离子电极是复合型的，只要插入**“pH/mV/ISE”**插座就可以了，如果不是复合型的，还应选择合适的参比电极，将参比电极接入**“REF”**插座，二支电极同时测试才行。

5.2. 注意事项:

5.2.1. ORP 测试时仪器无需校准，但如果对 ORP 电极的品质或测试结果有疑问时，可使用 ORP 标准溶液测试其 mV 值,以判别 ORP 电极或仪器是否准确。

本厂可提供以下标准的 ORP 标准溶液：222mV(25℃)±15mV ORP 标准溶液，溶液保质期一年，参比电极内溶液为 3.5mol/L KCl。

表（5-1）

℃	mV	℃	mV	℃	mV	℃	mV
10	242	20	227	30	215	38	205
15	235	25	222	35	209	40	201

5.2.2. ORP 电极的清洗和活化：ORP 电极经长期使用后，铂金表面污染会导致测量不准

和响应慢，此时可用下列方法进行清洗活化：

(a) 对无机物污染，可将电极浸入 0.1mol/L 稀盐酸中 30min，用纯水清洗，再浸入电极浸泡液中 6 小时后使用；

(b) 对有机油污和油膜污染，可用洗涤剂清洗铂金表面后用纯水清洗，再浸入电极浸泡液中 6 小时后使用；

(c) 铂金表面污染严重，表面形成氧化膜，可用牙膏对铂金表面进行抛光，然后用纯水清洗，再浸入电极浸泡液中 6h 后使用。

5.3. 参数设置：

5.3.1. mV 和 ORP 测量参数设置一览表（见附表 1）

5.3.2. 参比电极电位设置：

(a) 在 mV 、ORP 或 EH 模式下长按 <MODE> 键，仪器进入 P1 模式，见图（5-1）；

(b) 按 <UNIT> 键数字依次右移并闪烁，在数字闪烁时按 <▲>或<▼>修改大小；

(c) 按 <MODE> 键进入下一项参数设置或按 <ENTER> 键确认并返回测量模式；

(d) 出厂设置为 204.6mV。



图（5-1）

注意：如果设置了与出厂设置不同的电位值，在 EH 测量模式时，在 LCD 右上角会显示“ UrEF ”图标。

5.3.3. 定时测量时间设置（P2）：

按 <MODE> 键进入 P2，定时测量时间设定请参见 P.11 第 4.4.6 条

5.3.4. 恢复出厂设置（P3）：

按 <MODE> 键进入 P3，恢复出厂设置请参见 P.12 第 4.4.10 条

6. 离子浓度测量：

6.1. 准备工作：

6.1.1. 接入电源,按<ON/OFF>键开机；短按 <MODE> 键切换至 ISE 测量模式；



图（6-1）

6.1.2. 安装电极架并适当调试，将 901 型搅拌器通电备用；

6.1.3. 将铵根离子选择电极、参比电极和温度电极，并接入仪器；并将铵离子选择电极与参比电极浸入 10^{-3}mol/L 或去离子水

中，活化几分钟即可。

6.1.4. 选择测量单位：按 <UNIT> 键选择 pX，mol/L，mg/L 或 ppm；

6.2. 参数设置：

6.2.1 离子浓度计测量参数设置一览表【见附表I】

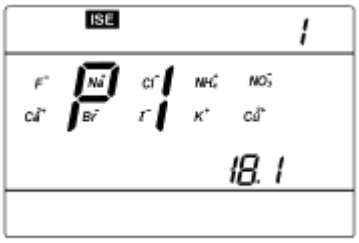


图6.2.2-1

6.2.2 使用其它离子选择电极时，要重新设置测试的离子。在“ ISE ”模式下，长按 <MODE> 键，LCD 界面显示如图（6.2.2-1），“NH_4^+”和“18.1”在闪烁。按<▲>或<▼>键选择需要的离子。调节完成，按 <MODE> 键，选择 P3。

6.2.3 当需要测试的离子菜单中没有时，需要设定，具体操作见附件 2。

6.2.4 校准溶液浓度值的设置（**P3**）：




图（6-2）

在样品浓度前后，配置二个铵离子校准溶液。校准溶液的浓度相差 100 倍之内较适当，不应大于 100 倍。然后，将二个校准溶液的浓度值设置到仪器中。例如：第一个校准溶液的铵离子浓度为 10^{-4}mol/L，即 pNH_4 为 4.00；第二个校准溶液的铵离子浓度为 10^{-2}mol/L，即 pNH_4 为 2.00。

（a） 长按 <MODE> 键进入 **P1** 模式，然后短按 <MODE> 键进入 **P2** 模式，再按此键进入 **P3** 模式。LCD 界面如图（6-2）所示，C1 表示第一种校准溶液设置。此时，显示器测量值的第一个数字会闪烁，即可用按<▲>或<▼>键调节数字；调节好后，按<UNIT>键数字闪烁右移，再调节数字；按此操作，直到数字调节好（例如 4.00）。

（b） 按 <ENTER> 键确认并进入**“C2”**设置，界面如图 (6-3) 所示，C2 表示第二种溶液设置。调整方法同上 6.2.1（a）。设置完成后，按<ENTER>键仪器进入测试状态。

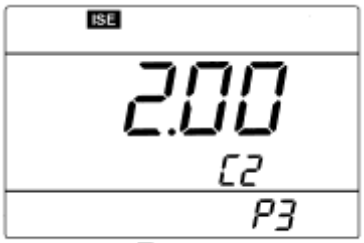

图（6-3）

当使用 mol/L、g/L、ppm 时，设定的校准溶液的调节方法见附件 1。

6.2.5 定时测量时间设置（**P4**）

在 **P3** 模式下短按 <MODE> 键进入 **P4** 模式，操作参见 P.11 第 4.4.6 条。

6.2.6 恢复出厂设置（**P5**）

在 **P4** 模式下短按 <MODE> 键进入 **P5** 模式，操作参见 P.12 第 4.4.10 条。

6.3 仪器校准：

6.3.1 经活化的铵离子选择性电极与参比电极，必须用纯水清洗。当与 1mol/L kCl 溶液的参比电极配套，电极经数次清洗后，用滤纸吸干。

6.3.2　将电极浸入第一个校准溶液（10^{-4}mol/L 铵离子校准溶液，pNH_4=4.00）中，用电极搅动溶液至少 10 秒，然后静置。按仪器<CAL>键，LCD 显示 4.00 和“ C1 ”，“ C1 ”闪烁，提示进入第一点校准，见图（6-4）。等待 2 分钟，仪器显示“ ☺ ”。



图6-4

6.3.3　再按 <CAL> 键，LCD 显示闪烁的“4.00”，几秒钟后校准结束，LCD 显示“4.00”和闪烁的“ C2 ”，见图（6-5）。提示第一点校准完成，进入第二点校准。第二个校准溶液是 10^{-2}mol/L 铵离子校准溶液（pNH_4=2.00）。

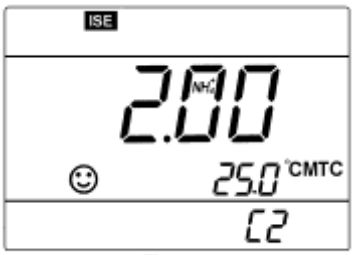


图6-5

6.3.4　将电极用滤纸吸干，放入第二个校准溶液中用电极搅动溶液至少 10 秒，然后静置，等待 2 分钟，仪器显示“ ☺ ”。再次按 <CAL> 键，LCD 显示闪烁的“2.00”，几秒钟后校准结束，LCD 显示“2.00”，左下角显示“ Ⓛ ”和“ Ⓗ ”见图（6-6）。仪器校准完成，进入测试状态。

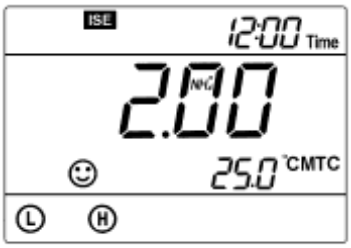


图6-6

注意：校准程序是先浓度低的校准溶液，后浓度高的校准溶液；仪器在校准时，只显示用户设置的标准溶液的数值，不显示测量值；校准时如果按 <UNIT> 键，会显示校准过程中电极的 mV 值的变化，按“CAL”键完成校准程序。

6.4　溶液测试：

6.4.1　仪器校准完成后，将电极在纯水中洗干净，并用滤纸吸干，浸入被测量溶液中，用电极搅动溶液至少 10 秒，然后静置。等待 2 分钟，出现“ ☺ ”图标后读数，记录溶液的测量值（pNH_4）。

6.4.2　按 <UNIT> 键可依次显示其它单位的离子浓度值。

6.4.3　将电极在纯水中洗干净，并用滤纸吸干，浸入第二份被测量溶液中，用电极搅动溶液至少 10 秒，然后静置。等待 2 分钟，出现“ ☺ ”图标后读数，记录溶液的测量值（pNH_4）。

6.4.4　取二次测量的平均值，即为样品溶液的铵离子浓度值。

6.5　注意事项：

6.5.1　由于离子测量种类很多，因此仪器不配置其它离子选择电极，用户根据需要选购离子电极。选择离子电极时，请特别注意离子电极的低浓度检测下限，以符合用户的使用要求。

选 择 单支的离子选择电极，必须选择相配的参比电极。通常参比电极的盐桥溶液是氯化钾（ KCl ）溶液，如果遇到钾离子电极和氯离子电极就不能使用，因为盐桥溶液中的

离子对离子电极有干扰。需要选择双盐桥的参比电极，外盐桥溶液选择与离子选择电极没有干扰的电解质溶液。

6.5.2　根据离子选择电极的特性，选择正确的总离子强度调节剂（TISAB）会使测量更稳定，尤其在离子电极的测量值下限时。使用时应注意在同体积的校准溶液和测量溶液中添加等量的总离子强度调节剂。

6.5.3　离子选择电极测试时，响应时间应不少于 2 分钟。在静止状态下测量，稳定性和重现性都好；在搅拌状态下测量，可提升离子电极的测量值的下限，但搅拌速度不宜过快，并且校准和测量时搅拌速度相同。

6.5.4　用户需自行配置二种合适的校准溶液，校准溶液的浓度应该在离子电极的测量范围之间，避免将校准溶液的浓度选择在离子电极的检测下限。为了保证测量准确性，被测溶液的测量值，应该在二个校准溶液浓度值之间。

6.5.5　在校准和测试过程中，如果是由稀到浓，电极使用时无需清洗，只要将电极吸干就可以了。如果是由浓到稀，电极要用纯水清洗干净，否则会影响准确度。

6.5.6　离子电极的校准溶液没有缓冲性，容易受沾污和稀释，尤其是浓度低的溶液。因此校准溶液配制要非常仔细，使用中要十分注意清洁和电极干燥，防止沾污和稀释。

6.5.7　仪器对离子电极的校准溶液没有识别能力，因此校准时必须按照 LCD 上闪烁的**“**C1**”**或**“**C2**”**符号将电极浸入相应的校准溶液中。否则会出现很大的误差甚至无法使用。

6.5.8　仪器必须校准后才能使用。在校准完成前，仪器显示的数值是不准确的。

6.5.9　当仪器校准或显示出现不正常时，请设置 **P5** 为“On**”**，使仪器恢复出厂设置状态，再进行校准和测试。

6.5.10　请不要在开机时拔出电源，只有在仪器关机后才能拔出电源适配器的插头。

7. 901 型智能搅拌器使用说明:

7.1. 技术规格:

调速范围	0 ~ 2300 转/分（空载）
最大工作电流	150mA
最大功耗	0.9W
工作面直径	Φ100mm
最大搅拌容量	1000ml
电源	DC6V 电源适配器或 AA 电池 4 节
尺寸及重量	100 × 146 × 48 mm　重 340 克

7.2.功能特点：

7.2.1. 采用微处理器芯片设计，可储存转速；

7.2.2. ABS 塑料外壳，透明顶盖，外形美观，轻薄小巧；

7.2.3. 可靠的防水型设计（防水等级 IP57）；

7.2.4. 交直流二用，可以随身携带在野外和现场使用，以及在培养箱内使用；

7.2.5. 电池低电压报警功能（<5V 时）。

7.3. 使用方法：

7.3.1. 插上 DC6V 电源适配器，或打开底盖装入 4 节 AA 电池；

7.3.2. 按<ON/OFF>键（绿色指示灯亮），表示搅拌器通电；按<▲>或<▼>键调节转速按 <RMP> 键（绿色指示灯亮），搅拌器按原来储存的转速工作；再按 <RMP> 键，关闭储存的转速，恢复刚才调节好的转速。因此在使用中，通过打开或关闭 <RMP>键，可交替实现二种转速。

7.3.3. 储存转速：长按 <RMP> 键 3 s，绿色指示灯闪烁，表示已储存该转速。下次开机后只要按 <RMP> 键即可出现该转速。

7.3.4. 搅拌器从零到最高转速分为 100 级，按<▲>键 100 次，即可达到最高转速，使用时可进行精细调节。但如长按<▲>键或<▼>键，可以快速增加或减少转速。

7.4. 注意事项：

7.4.1. 烧杯的底平面如果不平整，搅拌时会产生振动甚至无法搅拌，遇到这种情况应更换合格的烧杯。

7.4.2. 使用电池供电时，如果电量低于 5V，面板下方的红色指示灯会点亮，表示原来设定的标准转速会降低，应及时更换电池。但此时搅拌器依然会工作，只是转速有些降低，按<▲>键可以增加转速，如果用户不在乎原来设定的标准转速的准确性，即使红色指示灯点亮搅拌器依然能够工作，直至电池电量耗尽为止。

7.4.3. 在零转速情况下，不要长按 <RMP> 键，否则会误设置成零转速 — 按 <RMP> 键绿灯不亮，转速为零，此时只要按<▲>键并重新设置即可。

8. 仪器成套性：

8.1	MP523 型 pH/离子浓度测量电计	1 台
8.2	602 型万向电极架	1 个
8.3	901 型智能搅拌器	1 台
8.4	201T-M 塑壳 pH/ATC 三复合电极	1 支
8.5	NH502-US 铵离子电极	1 支
8.6	MP500 温度电极	1 支
8.7	6215 型参比电极（参比溶液：1M 氯化钾）	1 支
8.8	pH 校正缓冲溶液（pH4.00、pH6.86、pH9.18/50ml）	各 1 瓶
8.9	9V 电源适配器（仪器配用）	1 个
8.10	6V 电源适配器（搅拌器配用）	1 个
8.11	B628 搅拌珠	1 包
8.12	RS232 通讯电缆	1 根
8.13	MP523 通讯软件光盘	1 片
8.14	说明书	1 本
8.15	简要操作指南	1 份

9. 仪器保证事项：

仪器主机自购买日起 2 年内，电极自购买日起 6 个月内，因制造不良而不能工作，可免费修理或更换。以下情况不在保修范围内：

- 外在原因导致的损坏，如意外跌落、碰撞、不当使用等；
- 常规损耗和外观磨损；
- 未按照说明书要求的不当操作，未经授权的修理或修改；
- 其它厂方无法控制的外在因素

产品保修期是对用户购买产品提供免费服务的时间，不是指仪器或电极的使用寿命

附表Ⅰ 仪器参数设置一览表

模式	提示符	参数设置项目	代 码	参 数
pH	P1	pH 缓冲溶液系列选择	SOL	CH(中国系列) USA(欧美系列) NIS(NIST 系列) CUS(自定义)
	P2	纯水 pH 温度补偿设置	PU-1	OFF-On (关闭-设置)
	P3	加氨纯水 pH 温度补偿设置	PU-2	OFF-On (关闭-设置)
	P4	定时测量时间设置		（0-99） min
	P5	温度单位设置		℃ ℉
	P6	日期设置	Date	月 日 年
	P7	时间设置	Time	时 分
	P8	恢复出厂设置		OFF-On (关闭-设置)
mV/ ORP	P1	参比电极电位设置	UrEF	（0~999.9）mV
	P2	定时测量时间设置		（0~99）min
	P3	恢复出厂设置		OFF-On (关闭-设置)
离 子	P1	离子种类选择		F^-，Na^+，Cl^-，NH_4^+，NO_3^-，Ca^{2+}，Br^-，I^-，K^+，Cu^{2+}
	P2	自定义离子设置	CUS	自定义
	P3	校准溶液设置		C1 和 C2
	P4	定时测量时间设置		（0 ~ 99） min
	P5	恢复出厂设置		OFF~On（关闭-设置）

附表 II 仪器恢复出厂设置一览表

模式	提示符	参数设置项目	出厂设置内容	非出厂设置图标
pH	P2	纯水 pH 温度补偿设置	OFF	PU-1
	P3	加氨纯水 pH 温度补偿设置	OFF	PU-2
	P4	定时测量时间设置	0 秒	
mV	P1	参比电极电位设置	204.6mV	CUS
	P2	定时测量时间设置	0 秒	
离子	P2	自定义离子设置	OFF	CUS
	P6	定时测量时间设置	0 秒	

附表III 代码符号及缩写一览表

代码及缩写	英　　语	解　　释
SOL	Solution	标准溶液
CH	China	中国系列标准
USA	USA	欧美系列标准
nIS	NIST	NIST 系列标准
CUS	Custom	自定义溶液
PU-1	Pure-1	纯水 pH 温度补偿设置
PU-2	Pure-2	加氨纯水 pH 温度补偿设置
U-EF	Volt Reference	参比电极电位设置
End	End	
CAL	Calibration	
ISE	Ion Selectivity Electrode	
ORP	Oxidation-Reduction Potential	

附件 1： 校准溶液的其它浓度单位的设置过程

一、mol/L 单位：

以 NH_4^+ 校准溶液 C1=1.00×10^{-4}mol/L 和 C2=1.00×10^{-2}mol/L 为例：

1、进入 **P3**，LCD 界面如图-1 所示，C1 表示第一种校准溶液设置。此时，显示器测量值的第一个数字会闪烁，可按<▲>或<▼>键调节数字；调节好后，按 <UNIT> 键，数字闪烁右移，再调节数字；按此操作，直到数字调节好（例如 1.00）；再按 <UNIT> 键右上角“E-4”闪烁，可用按<▲>或<▼>键调节指数数字。

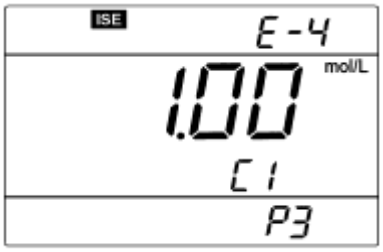


图-1

2、调整完成后，按 <CAL> 键确认并进入“C2”设置，LCD 界面如图-2 所示，C2 表示第二种校准溶液设置。按上述 1、相同的方法调节。完成后，按 <ENTER> 键仪器进入测试状态。

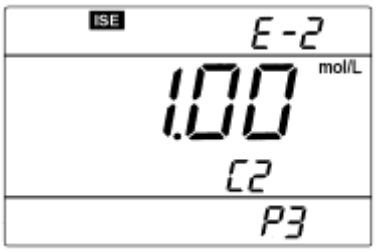


图-2

二、mg/L 和 ppm 单位：

以 NH_4^+ 校准溶液 C1=1.800mg/L 和 C2=180.0mg/L 为例：

1、在 **P3** 模式下，LCD 界面如图-3 所示，C1 表示第一种校准溶液设置。此时，显示器测量值的第一个数字会闪烁，按<▲>或<▼>键调节数字；调节好后，按 <UNIT> 键，数字闪烁右移，再调节数字；按此操作，直到数字调节好（例如 1.800）；再按 <UNIT> 键小数点闪烁，此时按<▲>或<▼>键小数点前移或后退。

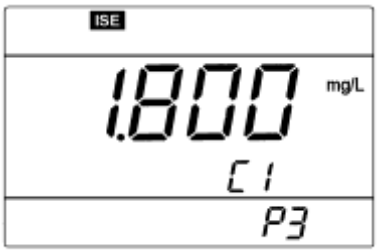


图-3

2、调整完成后， 按 <CAL> 键确认并进入“C2”设置，LCD 界面如图-4 所示，C2 表示第二种校准溶液设置。按上述 1、相同的方法调节。调整完成，按 <ENTER> 键仪器进入测试状态。



图-4

注意：离子选择性电极的校准程序，先浓度低，后浓度高。

附件 2：菜单中没有列出的离子的设定

当需要测试的离子，菜单中没有列出时，按 <MODE> 键进入 P1，再按 <MODE> 键进入 P2，LCD 界面显示如图 1。接着按 <UNIT> 键，LCD 界面显示如图 2，右上角“1”闪烁。



图1

注意：如果原设置是 CUS，按 <MODE> 键进入 P1，再 按 <MODE> 键进入 P2，LCD 界面不显示图 1，而显示图 2。

右上角闪烁的“1”表示离子的价数，按<▼>或<▲>键，可以增加或减少离子的价数（离子价数从 -3 ~ 3 ）。再按<UNIT> 键，界面上数字首位会闪烁，此项数字是表示离子的量。根据所选择的离子量，按<▼>或<▲>键，增加或减少数字；按 <UNIT> 健，可以位移闪烁的数字。

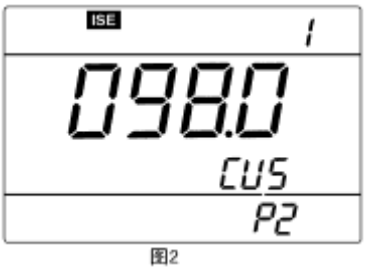


图2

当离子价数和离子量设定完成，接着按 <MODE> 键进入 P3，按配制的校准溶液，设定校准溶液的离子浓度值。

当校准溶液的浓度值设定完成后，按 <ENTER> 键，仪器显示进入测试状态。

注意：

1、本设置经用校准溶液校准后，即可测试样品（可多次测试）。如果要再次校准，就要重新设定。

2、当设定自定义模式后，测量界面将不显示离子符号，提示这是自定义模式下的测量界面；此时如果在 P1 模式中设定任何一种离子（如“Ca^{2+}”），自定义界面会自动关闭，测量界面将显示离子符号（如“Ca^{2+}”）。

附件 3：铵离子选择电极使用的相关溶液和试剂

一、校准仪器用的校准溶液：

0.1mol/L NH_4^+校准溶液：取优级纯(GR)氯化氨(NH_4Cl，53.491g/mol·L^{-1})，放入称量瓶中，在 105℃下烘干 2h，取出置于干燥器中，冷却至室温。 称取 5.3491g 氯化氨于烧杯中，用蒸馏水溶解后移入 1 升容量瓶中，并用蒸馏水洗烧杯，溶液移入容量瓶，经三次洗烧杯后，用蒸馏水稀释到刻度，混匀，备用。

附：1000mg/L NH_4^+校准溶液：取优级纯(GR)氯化氨(NH_4Cl，53.491g/mol·L^{-1})，放入称量瓶中，在 105℃下烘干 2h，取出置于干燥器中，冷却至室温。 称取 2.9654g 氯化氨于烧杯中，用蒸馏水溶解后移入 1 升容量瓶中，并用蒸馏水洗烧杯，溶液移入容量瓶，经三次洗烧杯后，用蒸馏水稀释到刻度，混匀，备用。

以上 NH_4^+ 校准溶液作为母液，可储存半年。用此溶液来配制校准仪器的各种 NH_4^+ 浓度的校准溶液。

并按下式求取配制其它铵离子浓度所需 0.1mol/L 铵离子校准溶液的量。

$$V_1M_1 = V_2M_2$$

式中：V_1— 0.1mol/L 校准溶液的体积，ml；

M_1— 0.1mol/L 校准溶液的标定浓度，mol/L；

V_2— 配制溶液的体积，ml；

M_2— 配制溶液的浓度，mol/L。

通常采用十倍稀释的方法配制各级校准溶液。

注：① 配制铵离子校准溶液的高纯水应符合以下要求：电导率小于 1μS/cm，

② pNH_4 4.00、pNH_4 5.00 铵离子溶液应该随配随用。

二、参比电极外参比溶液：

1mol/L 氯化钾(KCl)水溶液：称取 7.454g 氯化钾于烧杯中，用蒸馏水溶解，并稀至 100ml，摇匀，备用。

三、离子强度调节剂：

5mol/L 氯化钾(NaCl)水溶液：称取 29.22 氯化钠于烧杯中，用蒸馏水溶解，并稀至 100ml，摇匀，备用。

上海三信仪表厂

地址：上海市桂平路 481 号 16 幢 4 楼 (漕河泾工业开发区内)　邮编：200233

电话：021-63362480　　传真：021-64956880

网址：www.shanghaisanxin.com　　E-mail:wxmab@shsan-xin.com